

INFORMATION

No. 30016

平成30年9月14日

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、特異的IgE「ヒノキ」につきまして、改良試薬に変更いたします。報告範囲、判定基準等の変更は一切ありませんが、改良試薬では測定値が従来試薬より高値傾向となりますので、ご案内させていただきます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

【変更日】 2018年10月1日（月）ご依頼分より

【変更項目】

| 手びき 掲載頁 | 項目 コード | 検査項目 | 備考 |
|------------|-----------|------------|----------|
| 100 101 | 1876 | 特異的IgE ヒノキ | 改良試薬への変更 |

※ 裏面もご参照下さい。

- 基準値、判定基準、報告範囲等、検査要項の変更は一切ありません。




一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1510

【新試薬と現行試薬の相関図】

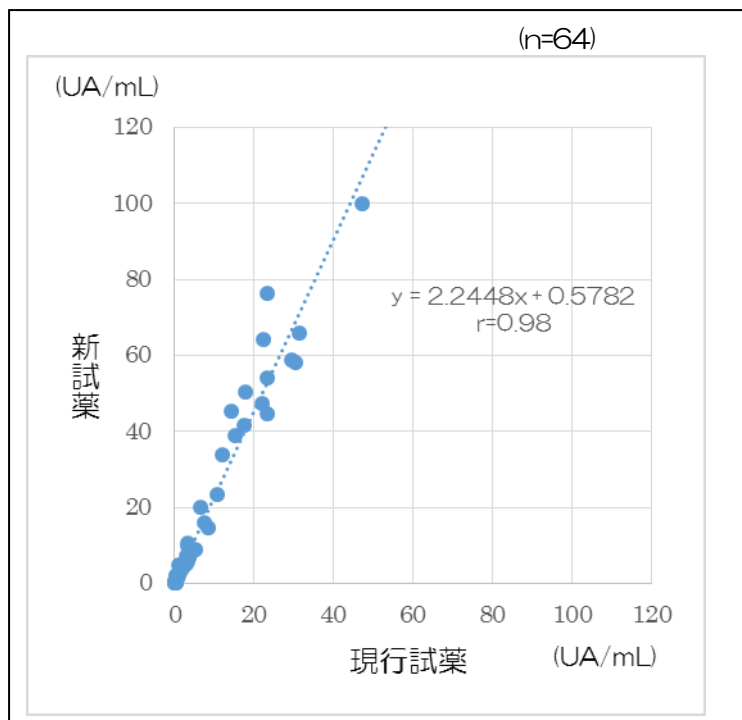

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|---|---|---|--|
| 新試薬 | 6 | | | | | 1 | | |
| | 5 | | | | | 7 | | |
| | 4 | | | | 6 | 2 | | |
| | 3 | | | 10 | 8 | | | |
| | 2 | 3 | 11 | 1 | | | | |
| | 1 | 5 | 3 | | | | | |
| | 0 | 7 | | | | | | |
| クラス | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

現行試薬

陰性一致率： 7/15 47%

陽性一致率： 35/35 100%