

INFORMATION

No. 30032

2018年11月15日

検査センター内アッセイ開始および 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、HCG 定量(血中)を本会検査センター内で実施することと致しましたのでご案内申し上げます。

結果報告書は本会検査センターの報告書で報告致します。検査結果報告には従来3~5日要しておりましたが、翌日の報告となりますので、尚一層のご利用をお願い申し上げます。

また、F-T4 の検査内容の変更をさせて頂きたくご案内申し上げます。

敬 白

記

【変更日】 2018年12月1日(土) 受付分より

【変更項目及び変更内容】

手びき 掲載頁	項 目 コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
85	2520	HCG 定量(血中)	項目コード	341	2520	
			報告日数	翌日	3~5日	
			検査方法	ECLIA	CLEIA	
			基準値	3.0以下	2.7以下	
			報告下限値	0.5以下	1.0以下	
74	336	遊離サイロキシン (F-T4)	報告下限値	0.039以下	0.023以下	改良試薬発売 のため

※裏面もご参照ください。



一般社団法人


福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1510

【新法と現行法の相関図】

●HCG 定量(血中)

n=43

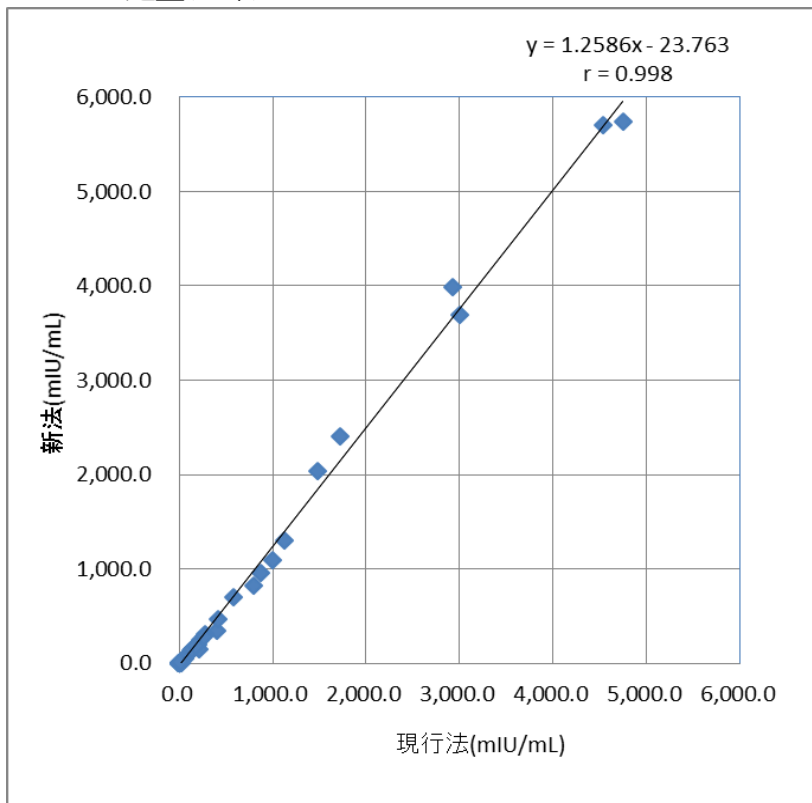

●F-T4

n=150

